


水銀血圧計の水銀タンクの戻し方



①水銀が入った状態です。
(目盛りに水銀が見えます。)

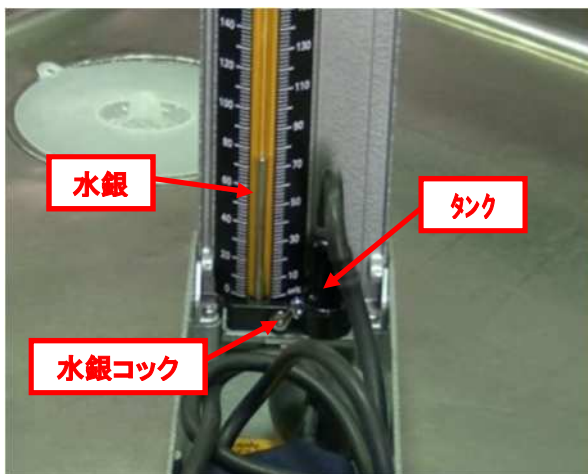

②水銀コックをつまんで左に回します。




③目盛りの水銀が、みるみるタンク内に戻ります。(目盛りが下がりきるまで待ちます。)



④下がり切ったら右45度傾けます。
(タンク内に水銀が入り切ります。)



⑤右45度に傾けた状態で、水銀コックを右に戻します。

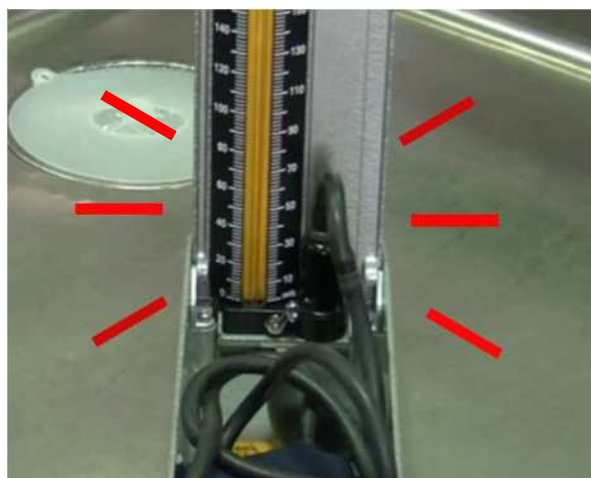

⑥完了です。(全体の作業は約15秒です)